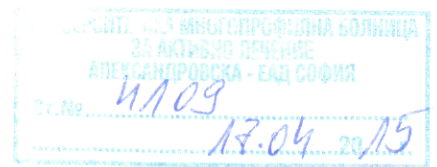
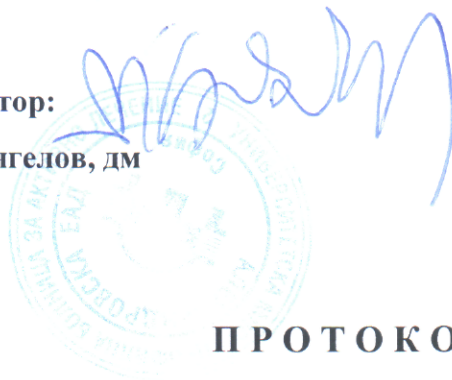


Изпълнителен директор:

доц. д-р Костадин Ангелов, дм

17.04.2015г.



ПРОТОКОЛ

По чл.72, ал.1 от ЗОП

От работата на комисията, назначена със Заповед № 3-43/13.02.2015г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на универсални електрохирургични платформи” за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, обявена с Решение № 3-528/23.12.2014г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, обявление, публикувано на страницата на Агенцията за обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки под № 00360-2014-0033 и в профила на купувача на интернет адрес www.alexandrovska.com.

Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц.д-р Димитър Буланов – зам.директор по лечебната дейност

ЧЛЕНОВЕ:

1. проф. д-р Георги Тодоров – началник на „Клиника по хирургия”
2. д-р Петър Грибнев – началник Операционен блок на „Клиника по хирургия”
3. доц. д-р Атанас Йонков – началник на Операционен блок на „КОЧПХ”
4. инж. Венелин Минчев – ръководител сектор „Медицинска апаратура, информационни системи и дейности” в отдел „Управление на собствеността”
5. Златина Георгиева – Юрисконсулт в отдел”ПНО”
6. Даниела Цекова – Главен юрисконсулт в отдел „ПНО”

Комисията изготви протокол с Вт № 2060/23.02.2015г. по чл.68, ал.7 от ЗОП, с който констатира съответствието на документите в плик № 1 на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците. Комисията провери съответствието на описанията, посочени от участниците с представените каталози на производителите.

Комисията констатира следното:

1. За участника „PCP” ЕООД – предлаганата апаратура е модел Force Triad, 2014г., производство на Covidien, USA. Апаратурата отговаря напълно на параметрите, техническите характеристики, функциите на апаратурата, поставени от възложителя в техническата спецификация.

2. За участника „МЕДИМАГ - МС” ООД - предлаганата апаратура е модел ARC 350, 2015г., производство на BOWA – Electronic GmbH & Co.KG .

В „Техническото предложение” на участника са описани параметрите, техническите характеристики и функциите на предлаганата апаратура. При сравнение с Приложение №1 „ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от документацията и представения каталог на производителя, който възложителят е изискал за да бъдат проверени параметрите, техническите характеристики и функциите на апаратурата, описани от участника

с тези на производителя, комисията установи несъответствия с изискванията на възложителя, както следва:

По т.3 Два извода за инструменти за запояване (фузия) на тъкани с две гнезда за включване на педали за активация на инструментите

Предложената платформа не притежава два извода за инструменти за запояване (фузия), а е с 2бр. моно и 2 бр. биполярни изводи.

По т.5 Контрол/обратна връзка с мониторинг – възможност за контролирана промяна на волтажа, мощността и силата на тока като функция на промяната на импеданса на тъканта в реално време – от 3000 до 4000 пъти в секунда.

За предложената платформа липсва посочена стойност, отбелязана е само технология.

По т.7 Автоматично разпознаване на инструментите и подаване на оптимална мощност, както и автоматично просветляване на активния “touch screen”екран за съответния инструмент.

Въпреки, че участникът е посочил наличие на такава функция, няма в каталога автоматично просветляване на активния “touch screen”екран.

По т.10 Възможност за промяна на мощността и режима на работа (рязане, коагулация или дисекция с хемостаза) от стерилното поле (работната ръкохватка).

Въпреки, че участникът е посочил наличие на такава функция, същото не се доказва с каталога.

По т.13 Автоматично разпознаване на ситуации на неправилно запояване (фузия) и изписване на минимум 6 различни предупреждения на екрана.

Въпреки, че участникът е посочил наличие на такава функция, същото не се доказва с каталога.

Инструменти:

По т.1 Еднократен монополярен активен електрод (ръкохватка) с 3 бутона за режим на работа рязане, коагулация и дисекция с хемостаза, с възможност за промяна на мощността чрез плъзгач - потенциометър от стерилното поле (от ръкохватката).

Участникът е посочил в описанието си наличие на еднократен монополярен активен електрод (ръкохватка) с бутони за режим на работа рязане, коагулация и дисекция с хемостаза. От каталога е видно, че електрода е с 2 бутона, т.е. няма наличие на 3 бутона.

С установените несъответствия на предложената електрохирургична платформа, комисията счита, че е нарушено изискването на възложителя, записано в Приложение № 1 **ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:** “Съответствието на предлаганите апарати от участниците с посочените от възложителя технически изисквания и инструменти е задължително”.

На основание гореизложеното и чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП /оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя – несъответствия с техническата спецификация на възложителя/, комисията предлага за отстраняване участника „МЕДИМАГ–МС” ООД, ЕИК: 130871925, с адрес на управление: гр. София 1404, кв. „Манастирски ливади - Изток”, ул. „Димитър Сагаев” № 19, представлявано от Силвия Асенова Петрова – Управител

Комисията взе решение отварянето и оповестяването на ценовите оферти да се състои на 09.04.2015г.09.30 часа, като съобщението да бъде публикувано в профила на купувача и изпратено до участниците, с участието на Златина Георгиева – резервен член на мястото на Десислава Ганчева / поради прекратяване на трудовото правоотношение/

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, със съобщение с изх. № 1103/06.04.2015г. комисията уведоми участниците за деня и часа на отваряне на пликете с „Предлагана цена”.

На 09. 04. 2015г. в 09.30 часа комисията се събра, за да отвори и обяви ценовите оферти на допуснатите участници. На отварянето на ценовите оферти присъства представител на фирма „МЕДИМАГ – МС”ООД – Станислав Маринов Иванов – с пълномощно от управителя.

Ценовата оферта на допуснатия участник „РСР” ЕООД се отвори и обяви от комисията и е следната:

Крайна цена за доставка на 1 брой универсална електрохирургична платформа 83 331.60 лв. /осемдесет и три хиляди триста тридесет и един лв. и шестдесет ст./ с вкл. 20 % ДДС.

Крайна обща цена за доставка на 3 броя универсална електрохирургична платформа 249 994. 80 лв. /двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири лв. и осемдесет ст./ с вкл. 20 % ДДС.

Комисията продължи своята работа без присъствието на представители на участниците.

Оценяване и класиране на офертата

Оценяването на ценовата оферта е извършено на база посочения в обявлението за обществената поръчка критерий „Най-ниска цена” и в съответствие с условията, посочени от възложителя в документацията за участие.

В резултат на работата си, комисията прави следното класиране:

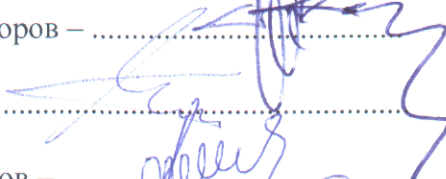
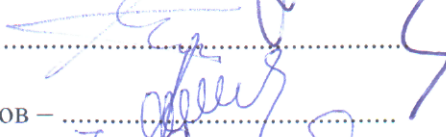
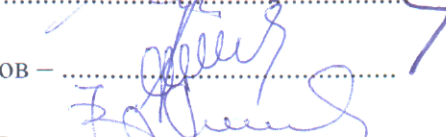
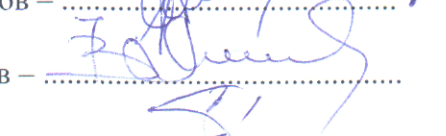
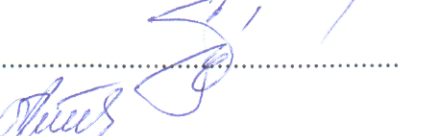
1-во място – „РСР” ЕООД – крайна обща цена за доставка на 3 броя универсална електрохирургична платформа - 249 994. 80 лв. /двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири лв. и осемдесет ст./ с вкл. 20 % ДДС.

Комисията предава на Изпълнителния директор настоящия протокол на основание чл.72, ал.3 от ЗОП, заедно с Протокол Вт.№ 2060/23.02.2015г. по чл. 68, ал.7, като предлага на Изпълнителния директор да възложи обществената поръчка на „РСР” ЕООД.

Дата на съставяне на протокола 18.04......2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Димитър Буланов – 

ЧЛЕНОВЕ:

1. проф. д-р Георги Тодоров – 
2. д-р Петър Грибнев – 
3. доц. д-р Атанас Йонков – 
4. инж. Венелин Минчев – 
5. Златина Георгиева – 
6. Даниела Цекова – 